



view 2: table Poste mobile (6 x)

Komm.: INPG, Grenoble

GS-certified
laboratory system
(certified safety)

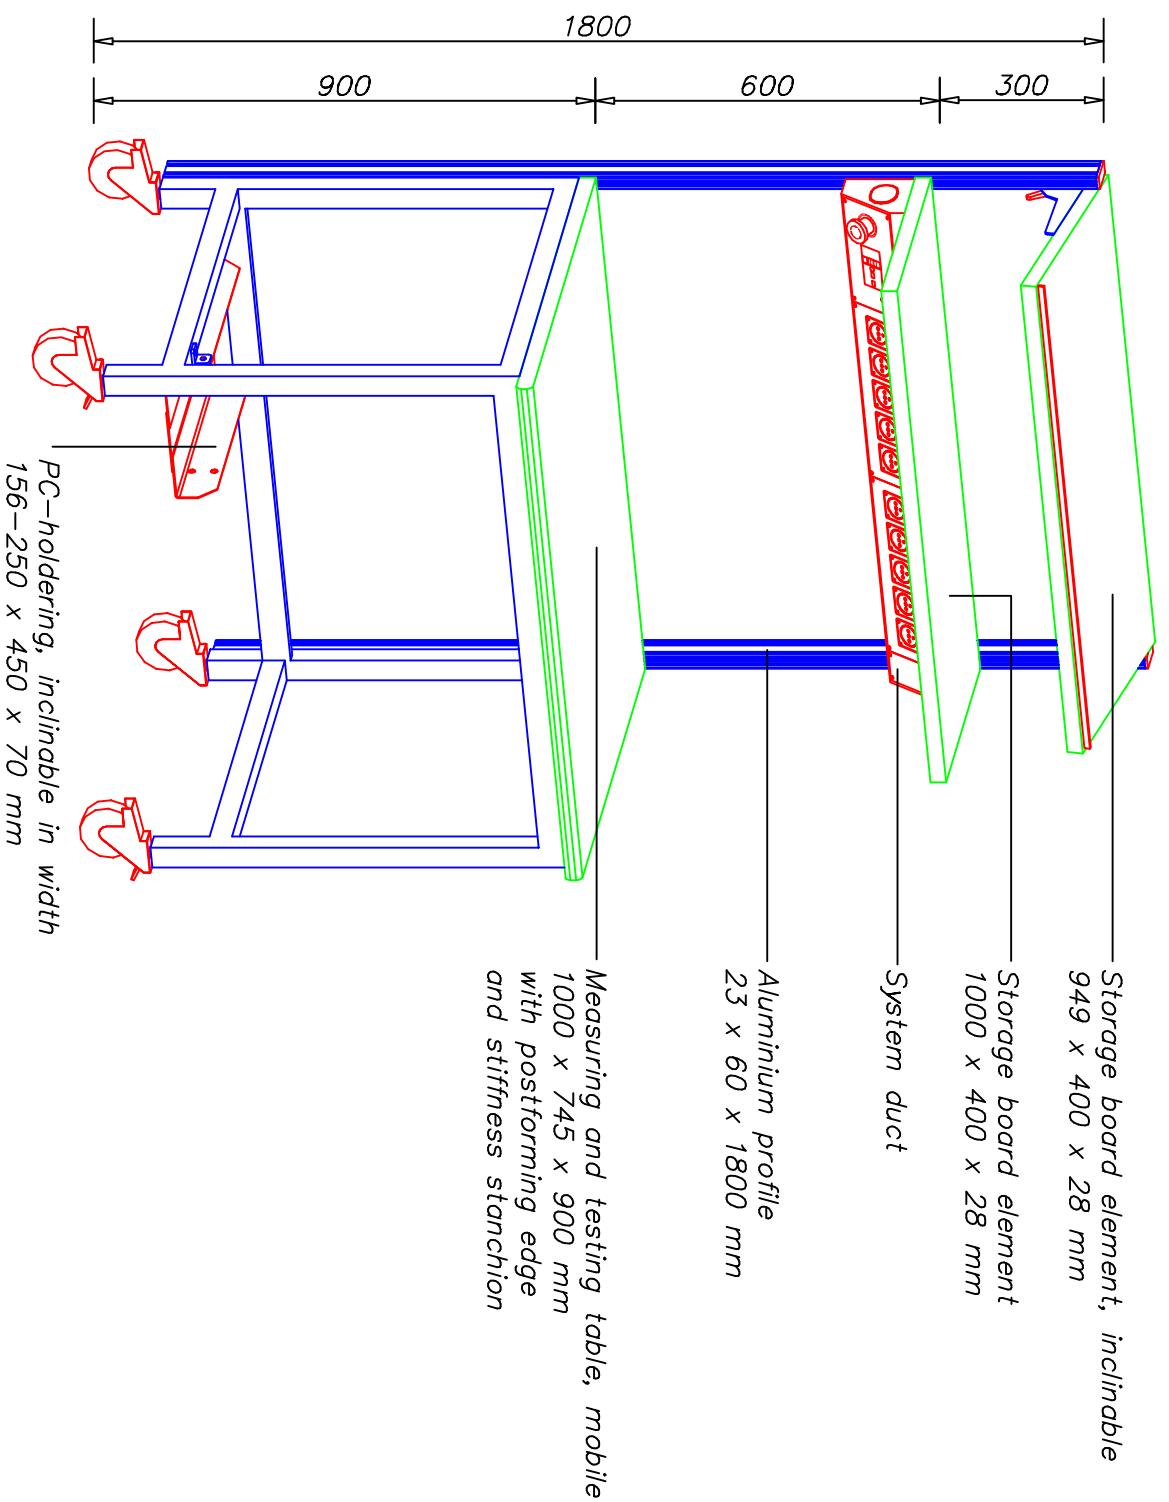



M = 1:20

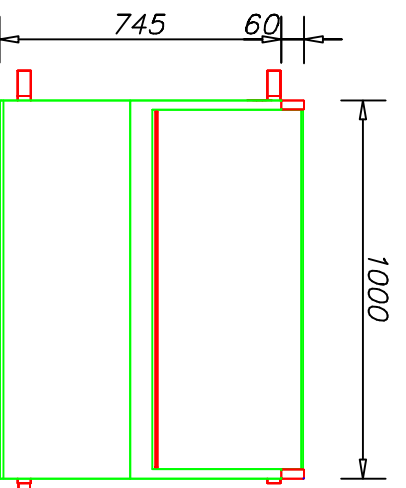

For these technical data
all rights are reserved.
Particularly duplications,
utilization or notification
of the contents to third
persons are not allowed.

equipment of the system duct M = 1:10

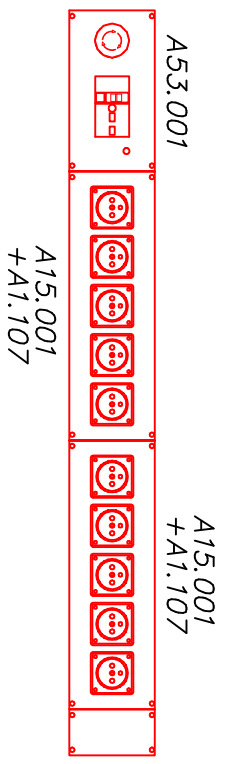

 <p>Ernst Fischer GmbH & Co.KG Meß- und Prüfgeräte Labor- und Arbeitsplatz- systeme, Testsysteme, D-72250 Freudenstadt</p>		2006	Datum	20.06.	gs	1:20	Freigebliebenheiten nach DIN 7168 mittel	Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor!	Anderungen	Nr.	Datum	Name
		Bearb.	Gepr.	Norm	AG6768				Kunde:			
Angebots-Nr.		Benennung		Ersatz durch		Ersatz für		Mobitest 8, rue Alfred de Vigny F 25000 Besancon				